


# Doro 450



Deutsch  
Español  
Français  
Italiano  
Nederlands

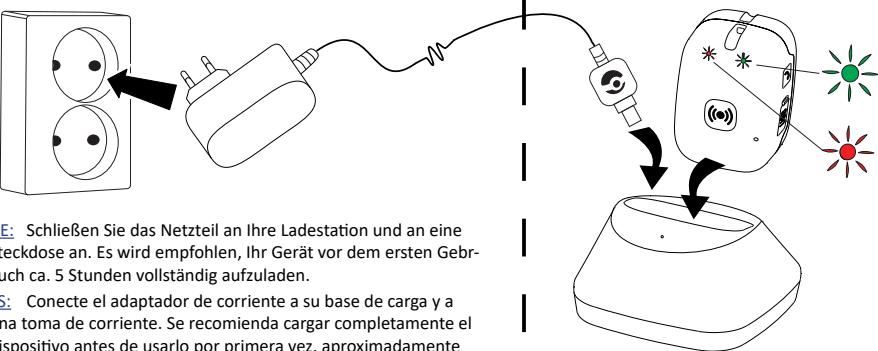

**DE:** Schließen Sie das Netzteil an Ihre Ladestation und an eine Steckdose an. Es wird empfohlen, Ihr Gerät vor dem ersten Gebrauch auch ca. 5 Stunden vollständig aufzuladen.

**ES:** Conecte el adaptador de corriente a su base de carga y a una toma de corriente. Se recomienda cargar completamente el dispositivo antes de usarlo por primera vez, aproximadamente 5 horas.

**FR:** Connectez l'adaptateur secteur à votre socle-chARGEUR et à une prise murale. Il est recommandé de charger complètement votre appareil avant la première utilisation, soit environ 5 heures.

**IT:** Collegare l'alimentatore di rete alla base di ricarica e alla presa di corrente. Si consiglia di caricare completamente il dispositivo prima del primo utilizzo, per circa 5 ore.

**NL:** Sluit de netadapter aan op uw oplaadstation en op een stopcontact. Het wordt aanbevolen om uw apparaat voor het eerste gebruik ongeveer 5 uur volledig op te laden.




**DE:** Normalbetrieb, grüne LED blinkt alle 3 Sekunden.

**ES:** Funcionamiento normal, parpadeo verde cada 3 segundos.

**FR:** Fonctionnement normal, clignotement vert toutes les 3 secondes.

**IT:** Funzionamento normale, il LED verde lampeggi ogni 3 secondi.

**NL:** Normaal bedrijf, groen knippert elke 3 seconden.




**DE:** Batterie schwach, rote LED blinkt alle 3 Sekunden.

**ES:** Batería baja, parpadeo rojo cada 3 segundos.

**FR:** Batterie faible, clignotement rouge toutes les 3 secondes.

**IT:** Batteria scarica, il LED rosso lampeggia ogni 3 secondi.

**NL:** Batterij bijna leeg, rood knippert elke 3 seconden.



**DE:** Kein Netzwerkdienst, rote LED blinkt alle 3 Sekunden zweimal. Wechseln Sie nach Möglichkeit auf ein Mobilfunknetz mit besserer Abdeckung.

**ES:** Sin servicio de red, parpadeo rojo dos veces cada 3 segundos. Si es posible, cambie a la cobertura de red móvil disponible.

**FR:** Pas de réseau, deux clignotements rouges toutes les 3 secondes. Si possible, basculez sur la couverture de réseau mobile disponible.

**IT:** Nessun servizio di rete, il LED rosso lampeggia due volte ogni 3 secondi. Se possibile, passare alla copertura di rete mobile disponibile.

**NL:** Geen netwerkservice, rood knippert twee keer elke 3 seconden. Ga indien mogelijk naar de beschikbare mobiele netwerkdekking.


**DE:** Gerät wird geladen; grüne LED blinkt alle 3 Sekunden.

**ES:** Cargando, parpadeo verde cada 3 segundos.


**FR:** En charge, clignotement vert toutes les 3 secondes.

**IT:** In carica, il LED verde lampeggi ogni 3 secondi.

**NL:** Bezig met opladen, groen knippert elke 3 seconden.



## Alarm

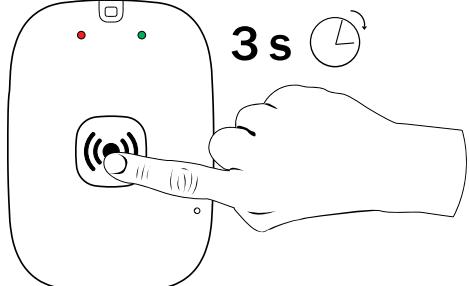



**DE:** Optional: Drücken Sie innerhalb von 30 Sekunden nach Auslösen des Alarms, um einen versehentlich ausgelösten Alarm zu löschen.

**ES:** Opcional, pulse en los 30 segundos posteriores al inicio de la alarma para cancelar cualquier alarma falsa.

**FR:** Vous pouvez appuyer sur dans les 30 secondes suivant le déclenchement de l'alarme pour annuler toute alarme déclenchée par erreur.

**IT:** Opzionale, premere entro 30 secondi dall'attivazione dell'allarme per annullare qualsiasi allarme attivato erroneamente.

**NL:** Druk optioneel binnen 30 seconden op om een vals geactiveerd alarm te annuleren.

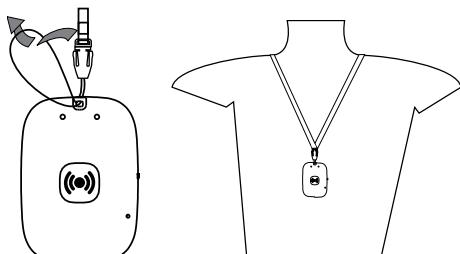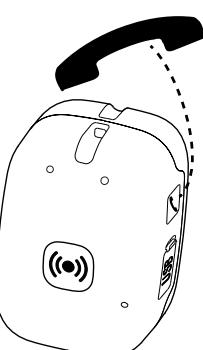

**DE:** Gerät ist vollständig geladen, grüne LED leuchtet durchgängig.

**ES:** Totalmente cargado, verde fijo encendido.

**FR:** Charge complète, lumière verte fixe.

**IT:** Carica completa, LED verde fisso.

**NL:** Volledig opladen, groen brandt continu.


**DE:** Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt oder drücken Sie sie 3 Mal schnell hintereinander, um einen Alarm auszulösen.

**ES:** Mantenga pulsado durante 3 segundos o pulse 3 veces rápidamente para iniciar una alarma.

**FR:** Appuyez sur la touche pendant 3 secondes ou appuyez 3 fois rapidement pour déclencher une alarme.

**IT:** Premere e tenere premuto per 3 secondi o premerlo velocemente 3 volte per attivare un allarme.

**NL:** Houd 3 seconden ingedrukt of druk 3 keer snel om een alarm te activeren.

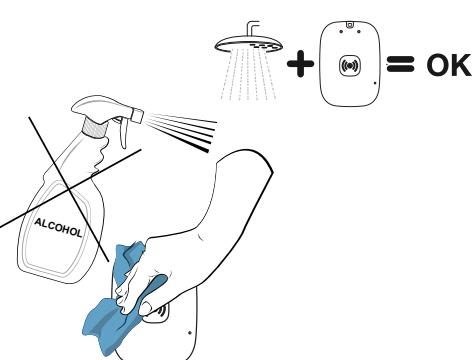

## DEUTSCH

### EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Doro AB, dass dieses Funkgerät der Richtlinie 2014/53/EU (RED) entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender URL verfügbar: [www.doro.com/doc/](http://www.doro.com/doc/).

### Produktinformationen

Dieses Produkt ist ein Teil eines Haushaltsgeräts, das im Notfall, oder wenn Hilfe benötigt wird, einen Hilferuf absetzt. \*Frequenzband (MHz), [Maximale Funkfrequenzleistung, dBm]

### Sicherheitshinweise

**VORSICHT:**  
Das Gerät und das Zubehör können Kleinteile enthalten. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Der Netzadapter ist das Trenngerät zwischen dem Telefon und dem Stromnetz. Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.

Bewahren Sie alle Vorschriften, die an Ihnen gewisse Aufmerksamkeit fordern, und schalten Sie das Gerät ab, wenn ein Gebrauch mit einem oder anderen Gerät verhindert werden kann. Verwenden Sie das Gerät immer in der normalen Gehäuseposition. Das Gerät darf niemals bei Betriebstemperaturen über 40 °C oder unter -20 °C verwendet werden.

### Medizinische Geräte

Der Gebrauch von Geräten, die Funksignale aussenden, wie z. B. Mobiltelefone, kann den Betrieb medizinischer Geräte stören, wenn diese nicht ausreichend geschützt sind. Wenn Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des Geräts wenden, um sicherzustellen, dass gegenwärtig kein Funksignal ausreichend geschützt ist, oder wenn Sie andere Fragen haben, ist der Gebrauch des Geräts in Krankenhäusern oder ärztlichen Einrichtungen untersagt, so schalten Sie es bitte ab. In Krankenhäusern und anderen ärztlichen Einrichtungen werden manchmal Geräte benutzt, die durch externe Funksignale gestört werden können.

**Medizinische Implantate**  
Um mögliche Funkinterferenzen medizinischer Implantate zu vermeiden, empfehlen Implantathersteller einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobiltelefonen und dem Implantat. Personen, die solche Implantate tragen, sollten folgende Maßnahmen ergreifen:

- Halten Sie immer den Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobiltelefon und medizinischem Implantat ein.
- Sie sollten das Telefon nicht in einer Brusttasche tragen.
- Halten Sie das Mobiltelefon nur an das Ohr, das der Körpersseite mit dem Implantat gegenüberliegt.

Schalten Sie das Telefon sofort aus, wenn Sie vermuten, dass eine Störung des medizinischen Implantats vorliegt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie weitere Fragen zur Nutzung von Mobiltelefonen durch Implantaträger haben.

**Lithium-Ionen-Akku**  
Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Bei unsachgemäßem Umgang mit dem Akku besteht Brand- und Verbrennungsfahrer.

**WAARSCHUWING:**  
Beladen en ontkennen van de batterij kan een explosieven gevaar opleveren. Om brand- en verbrenningsgevaar te verminderen, darf de akku niet zwaaien, doorschuren, kruisglossen, temperatuur over 60 °C (140 °F) of extreem hoge luchtvochtigheid aangezette worden met water en vuur in berührung gebracht worden. Gebruachte akkus mogen geen vorm of ontwerp hebben dat de oorspronkelijke vorm of ontwerp overschrijdt. De batterij moet worden verwijderd voordat deze wordt gerecycleerd.

**Specifieke Absorptiessraten (SAR)**  
Dieses Gerät erfüllt die internationale Sicherheitsvorschriften für die Funkwellenbelastung. Ihr Mobiltelefon ist ein Funkwellenemitter und -empfänger, ist jedoch, dass es von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection), das bedeutet Internationale Kommission für nicht ionisierende Strahlenschutz, bestätigt wurde, dass es sicher ist.

Der Richtlinien für Funkwellenemissionen basieren auf einem Maß, das die spezifische Absorptionsrate oder SAR bekannt ist. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte beträgt 2 Watt/Kilogramm (W/kg) als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körperteilgewebe. Die Belastungsgrenzen liegen innerhalb eines breiten Sicherheitsrahmens, mit dem die Sicherheit der Bevölkerung unabhängig von Alter oder Gesundheitszustand gewährleistet werden soll.

SAR-Prüfungen werden in standardmäßig getesteten Betriebspositionen durchgeführt, wobei das Gerät über alle geprüften Frequenzbändern bei höchstem bauteilgeprüften Leistungspegel übermittelt. Der maximale SAR-Wert gemäß den ICNIRP-Richtlinien für das Gerät beträgt:

### Körper SAR (5 mm): 1,373 W/kg

Bei normaler Verwendung des Geräts liegen die SAR-Werte für dieses Gerät normalerweise weit unter den oben angegebenen Werten. Dies kann durch das Annehmen oder die Verminderung oder die Minimierung von Störungen des Netzwerks die Ausgangssignale Ihres Mobiltelefons automatisch verringert wird, wenn das Gespräch nicht die volle Leistung benötigt wird. Je geringer die Ausgangssignale, desto geringer auch der SAR-Wert.

Dieses Gerät entspricht den Richtlinien hinsichtlich HF-Exposition bei normaler Benutzung am Ohr oder bei Positionierung mit 0,5 cm Abstand zum Körper. Wenn eine Gürtehalter, ein Gürtelclip oder eine Haltung verwendet wird, um das Gerät am Körper einzusetzen, sollte diese Vorrichtung kein Metall enthalten, und das Gerät sollte mindestens den oben angegebenen Abstand zum Körper aufweisen.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat ausgewiesen, dass es gemäß dem aktuellen wissenschaftlichen Informationsstand keinen Bedarf für spezielle Vorsichtsmassnahmen bezüglich der Verwendung von Mobiltelefonen gibt. Wenn Sie die Exposition reduzieren wollen, empfiehlt die WHO, die Nutzung einschrankender oder eine Freisprecheinrichtung zu verwenden, um das Risiko von Kopf und Körper fern zu halten.

### Umweltinformationen

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen aus den EU-Richtlinien 2006/66/EG (Batterien), 2012/19/EU (WEEE) und 2011/65/EU (RoHS2), die von der Europäischen Kommission erlassen wurden.

Dieses Produkt, sein elektronisches Zubehör (z. B. Ladeplatten, Headset, USB-kabel) und der Akku dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Wenden Sie sich entweder an den Händler/Lieferanten oder an Ihre örtliche Gemeindeverwaltung, um zu erfahren, wo und wie Sie diese Gegenstände dem umweltverträglichen Recycling zuführen können.

Weitere Informationen finden Sie im vollständigen Handbuch: [www.doro.com/care](http://www.doro.com/care)

### Ökodesign-Eklärung, Energieeffizienz für das externe Netzteil

Hiermit erklärt Doro, dass die externe Stromversorgung für dieses Gerät der Verordnung der Kommission (EU) 2019/1782 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an externe Netzteile gemäß der Richtlinie 2009/125/EG entspricht.

Die vollständigen Informationen zu den Ökodesign-Anforderungen sind unter folgender URL verfügbar:

[www.doro.com/ecodesign](http://www.doro.com/ecodesign)

### ESPAÑOL

#### Declaración de conformidad UE

Por la presente, Doro declara que este equipo de radio cumple con la Directiva 2014/53/UE (RED). El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: [www.doro.com/doc](http://www.doro.com/doc).

#### Información del producto

Este producto forma parte de un sistema de alarma social cuya finalidad es iniciar una llamada en caso de que se produzca una emergencia o de que se necesite asistencia.

- Banda de frecuencia (MHz). [Potencia de radiofrecuencia máxima, dBm]

#### Información sobre seguridad

##### PRECAUCIÓN

La unidad y los accesorios pueden contener componentes de pequeño tamaño. Mantenga todo el equipo lejos del alcance de los niños. El adaptador de red es el dispositivo de desconexión entre el producto y la toma de red. La toma de red debe estar cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.

Siga las normas y leyes aplicables al utilizar donde se encuentre y siempre la unidad cuando su uso esté probado o permitido por las autoridades competentes. Es importante que la unidad permanezca en la posición de uso normal. La unidad nunca debe utilizarse a una temperatura de funcionamiento superior a 40 °C inferior a -20 °C.

#### Unidades médicas

El uso de dispositivos que transmiten señales de radiofrecuencia, como teléfonos móviles, puede interferir con equipos médicos insuficientemente protegidos. Consulte a un médico o al fabricante del equipo para determinar si tiene una protección adecuada contra señales de radiofrecuencia externas o en casas de salud. Si hay cables en las instalaciones sanitarias indicadas que apagan la unidad mientras se encuentra en ellas y respetados. Los hospitales y otras instalaciones sanitarias a veces tienen equipos que la señal de radiofrecuencia externa puede verse afectada por señales de radiofrecuencia externa.

#### Dispositivos médicos implantados

Para evitar posibles interacciones, los fabricantes de dispositivos médicos implantados recomiendan una separación mínima de 15 cm entre un dispositivo inalmábrico y el dispositivo médico. Las personas que cuentan con estos dispositivos deben:

- Mantener en todo momento el dispositivo inalmábrico a más de 15 cm del dispositivo médico.
- No debe llevarse el dispositivo inalmábrico en un bolso junto al pecho.

• Coloque el dispositivo inalmábrico en la oreja contraria a la ubicación del dispositivo médico.

Si las personas que utilizan estos están produciendo interacciones, apague el teléfono inmediatamente. Si tiene alguna pregunta sobre el uso del dispositivo inalmábrico con un dispositivo médico implantado, consulte a su médico.

#### Batería de ion de litio

Este producto contiene una batería de ion de litio. Existe riesgo de incendio y quemaduras si la batería no se manipula de forma adecuada.

I test per il SAR sono stati eseguiti adottando posizioni di funzionamento standard, considerando il dispositivo con il livello massimo possibile di emissioni in tutte le bande di frequenza. I valori SAR più alti ai sensi delle linee guida ICNIRP per l'uso di questo modello di dispositivo sono:

#### SAR (5 mm): 1,373 W/kg

Dunque l'uso dell'unità, i valori SAR per questo dispositivo sono normalmente ben al di sotto dei valori sopra riportati. Questo perché il copri di energia del sistema e per ridurre al minimo le interazioni sulla rete, la potenza in uscita del dispositivo viene automaticamente eliminata quando non è necessaria la potenza completa per effettuare una chiamata. Minore è la potenza in uscita del dispositivo, minore è il valore SAR.

Questo dispositivo è conforme alle linee guida per l'esposizione alle radiofrequenze (RF) quando utilizzato all'orecchio oppure posizionato ad una distanza di 0,5 cm da una persona con il dispositivo di custodia, fermagli per la cintura o altri tipi di accessori da portare. Questo non deve contenere metallo e dovrebbe garantire una distanza dal corpo pari almeno a quella riportata sopra.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha stabilito che le attuali informazioni scientifiche non indicano la necessità di speciali precauzioni nell'utilizzo dei dispositivi mobili. Se, tuttavia, si desidera ridurre l'esposizione, viene raccomandato di ridurne l'uso o di utilizzare un accessorio vivavoce in modo da tenerle il dispositivo lontano dalla testa e dal corpo.

#### Informazioni ambientali

Questo prodotto è conforme ai requisiti della Direttiva UE 2006/66/CE (Batterie), 2012/19/EU (RAEE) e 2011/65/EU (RoHS2), compresa la Direttiva delegata (UE) 2015/863 che modifica l'allegato II.

Questo dispositivo non contiene elementi pericolosi (per es. carica/batteria, cuffie, casco USB) e la batteria non vanno smaltiti con rifiuti domestici. Contattate il rivenditore/fornitore o le autorità locali per sapere dove e con quali modalità riciclare correttamente tutti articoli.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel/nel manuale/ completo/ : [www.doro.com/care](http://www.doro.com/care)

#### Dichiarazione di progettazione ecocompatibile per il risparmio energetico degli alimentatori esterni

Con la presente, Doro dichiara che l'alimentatore esterno per questo dispositivo è conforme al Regolamento (UE) 2019/1782 della Commissione che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni in applicazione della Direttiva 2009/125/CE.

Informazioni complete riguardo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile sono disponibili all'indirizzo Internet: [www.doro.com/care](http://www.doro.com/care)

### NEDERLANDS

#### EG-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Doro AB dat deze radiotoestuur in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU (ROD). De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende internetadres: [www.doro.com/doc](http://www.doro.com/doc).

#### Productinformatie

Dit product is een deel van een sociaal-alarmsysteem bestemd om in een noodstadium of als hulp vereist is een oproep te doen uitgaan.

- Frequencyband (MHz). [Maximal radiofrequencyvermogen, dBm]

#### Veiligheidsinformatie

##### VOORZICHTIG

Het toestel en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd alle apparatuur buiten het bereik van kleine kinderen. De netadapter fungeert als uitschakelapparaat tussen het product en het elektriciteitsnet. Het stopcontact moet zich dicht bij de apparatuur bevinden en goed toegankelijk zijn.

Volg altijd en overal de geldende regels en wettelijke voorschriften op en schakel de apparatuur alleen in de gevraagde gebruiksanwijzing. Niet toegestaan of het stellen van gevarenlijke situaties kan veroorzaiken. Gebruik het toestel alleen in de gewone gebruiksanwijzing.

Het apparaat moet worden gebruikt in de normale lokaal of fare referentie alla guida in dotação con il prodotto.

#### Medische apparatuur

Fabrikanten van medische implantaten kunnen storingen veroorzaken in onvoldoende afgeschermd medische apparatuur. Raadpleeg arts of fabrikant van de apparatuur om te begrijpen dat deze voldoende is afgeschermd tegen externe radiofalen als u andere vallen heeft. Als in een zorginstelling bordjes hangen waarop staat dat u het toestel bij uw behoeft moet uitschakelen.

- houd het draadloze apparaat altijd meer dan 15 cm uit de buurt van het medische apparaat;
- Draag de telefoon niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat bij het andere oor dan het oor aan de kant van het medische apparaat.

#### Medische implantaten

Fabrikanten van medische implantaten raden een minimale afstand van 15 cm tussen een draadloos apparaat en het medische apparaat om mogelijke storing te voorkomen. Personen die dit soort apparaten hebben, moeten zich aan het volgende houden:

- houd het draadloze apparaat altijd meer dan 15 cm uit de buurt van het medische apparaat;

• Draag de telefoon niet in een borstzak.

- Houd het draadloze apparaat bij het andere oor dan het oor aan de kant van het medische apparaat.

### ADVERTENCIA

Peligro de explosión si la batería se sustituye de forma incorrecta. Para reducir el riesgo de incendio y quemaduras, no manipule la batería, por favor, certifique los contactos exteriores, exponga a temperaturas superiores a 60 °C (140 °F), expóngase a presiones de aire extremadamente bajas ni la deseche ni en el fuego ni en agua. Recicle o elimine las baterías usadas de acuerdo con las normativas locales o la guía de referencia suministrada con el producto.

Utilice únicamente la fuente de alimentación aprobada para este modelo en particular. La conexión de otras fuentes de alimentación podría resultar peligrosa e invalidar la homologación de tipo y la garantía del dispositivo.

#### Coeficiente de absorción específica (SAR)

Este dispositivo cumple con los requisitos internacionales de seguridad de exposición a la exposición a las ondas de radio. Su dispositivo móvil es un transmisor y receptor de radio. Se permite que no exceda los límites de exposición a la radiofrecuencia establecidos por la Comisión International de Radioprotección (ICNIRP).

Las directrices relativas a la exposición a las ondas de radio utilizan una unidad de medida conocida como coeficiente de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés). El límite de SAR para dispositivos móviles es de 2 W/kg de media por 10 g de tejido y incluye un margen considerable para garantizar la seguridad de todas las personas, independiente de edad, sexo y condición médica.

Las personas que utilizan dispositivos móviles deben mantener una distancia de al menos 15 mm entre la batería y el cuerpo. Los usuarios de dispositivos móviles se recomienda utilizar posiciones de funcionamiento estándar con el teléfono transmitiendo al nivel más alto de potencia certificada en todas las bandas de frecuencia comprobadas. De acuerdo con las directrices de la ICNIRP, los valores máximos de SAR de este dispositivo son:

#### Cuerpo SAR (5 mm): 1,373 W/kg

Al usar normal, los valores de SAR de este dispositivo estan muy bajo de los valores anteriores. Esto se debe a que, para minimizar la exposición del sistema y reducir las interacciones de la red, la potencia de salida del dispositivo móvil es menor. Sin embargo, la distancia entre el teléfono y la persona debe ser lo suficiente para garantizar la seguridad de las personas, independiente de edad, sexo y condición médica.

El dispositivo cumple las directrices de exposición de RF cuando se apoya contra la cabeza o se coloca a menos de 0,5 cm del cuerpo. Si se utiliza una funda para el círculo u otro soporte para llevar el dispositivo en el cuerpo, este no debe contener metales y debe mantener como mínimo la distancia indicada anteriormente con respecto al cuerpo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma, según los datos científicos actuales, que no es necesario utilizar precauciones especiales con un teléfono móvil usado de forma segura. Si se necesita reducir la exposición, el ICNIRP recomienda disminuir el uso o generalizar el uso de las fundas para el teléfono.

#### Información sobre el medio ambiente

Este producto cumple las exigencias establecidas en la directiva de la UE 2006/66/CE (baterías), 2012/19/EU (RAEE) y 2011/65/EU (RoHS2), incluyendo la directiva delegada (UE) 2015/863 para la que se modifica el Anexo II.

Este producto, sus accesorios electrónicos (ej., cargador, auriculares, cable USB) y la batería no deben desecharse junto con otros residuos domésticos. Póngase en contacto con el distribuidor/proveedor o con la oficina gubernamental local para obtener información detallada sobre las leyes y regulaciones nacionales y locales.

#### Declaración sobre el diseño ecológico y la eficiencia energética de las unidades externas de alimentación de emergencia de los servicios

Este producto cumple las exigencias establecidas en la directiva de la UE 2006/66/CE (baterías), 2012/19/EU (RAEE) y 2011/65/EU (RoHS2), incluyendo la directiva delegada (UE) 2015/863 para lo que se modifica el Anexo II.

Este producto cumple con las exigencias de diseño ecológico para las fuentes de alimentación para obtener la certificación de la UE 2019/1782 relativa a los requisitos de diseño ecológico para las fuentes de alimentación externas de conformidad con la Directiva 2009/125/CE.

La información completa sobre los requisitos de diseño ecológico está disponible en la siguiente dirección de Internet: [www.doro.com/ecodesign](http://www.doro.com/ecodesign)

#### FRANÇAIS

#### Déclaration de conformité CE

Doro AB déclare que cet équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE (directive RED). Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : [www.doro.com/doc](http://www.doro.com/doc)

#### Information produit

Cet appareil fait partie d'un système de télésignalisation destiné à émettre une alerte en cas d'urgence ou de demande d'aide.

- Bande de fréquence (MHz). [Puissance de radiofréquence maximale, dBm]

#### Information relative à la sécurité

##### ATTENTION

Tous les petits objets peuvent contenir de petites pièces. Gardez tout l'équipement hors de la portée des petits enfants. L'adaptateur secteur est le dispositif qui permet de brancher le produit à l'alimentation secteur. Le prise de courant doit se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible.

Suivez les règles et les lois qui s'appliquent à votre région et éteignez toujours l'appareil partout où son utilisation est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger quelconque. Utilisez uniquement l'appareil dans

As u denkt dat er sprake van storing is, schakel de telefoon en onmiddellijk uit. Raadpleeg uw arts als u wagen hebt over het gebruik van uw draadloze apparaat.

#### Li-ion-batterij

Dit product bevat een li-ionbatterij die voorzien is van een speciale bescherming tegen overbelasting. Het is niet toegestaan om de li-ionbatterij te demonteren, te doorboren, kortschakeling van de externe contacten te veroorzaken, het bloot te stellen aan temperaturen die buiten de normale gebruiksomgeving liggen of water of waterige vloeistoffen te geven.

Gebruik alleen de oplader die is goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model. Aansluiting van gevaarlijke en onstabiele opladers kan leiden tot beschadiging van de batterij.

#### Gevaar voor explosie als de batterij niet correct wordt geplaatst.

Het is niet toegestaan om dit product te demonteren, te doorboren, kortschakeling van de externe contacten te veroorzaken, het bloot te stellen aan temperaturen die buiten de normale gebruiksomgeving liggen of water of waterige vloeistoffen te geven.

#### Gevaar voor explosie als de batterij niet correct wordt geplaatst.

Het is niet toegestaan om de li-ionbatterij te demonteren, te doorboren, kortschakeling van de externe contacten te veroorzaken, het bloot te stellen aan temperaturen die buiten de normale gebruiksomgeving liggen of water of waterige vloeistoffen te geven.

#### Gevaar voor explosie als de batterij niet correct wordt geplaatst.

Het is niet toegestaan om de li-ionbatterij te demonteren, te doorboren, kortschakeling van de externe contacten te veroorzaken, het bloot te stellen aan temperaturen die buiten de normale gebruiksomgeving liggen of water of waterige vloeistoffen te geven.

#### Gevaar voor explosie als de batterij niet correct wordt geplaatst.

Het is niet toegestaan om de li-ionbatterij te demonteren, te doorboren, kortschakeling van de externe contacten te veroorzaken, het bloot te stellen aan temperaturen die buiten de normale gebruiksomgeving liggen of water of waterige vloeistoffen te geven.

#### Gevaar voor explosie als de batterij niet correct wordt geplaatst.

Het is niet toegestaan om de li-ionbatterij te demonteren, te doorboren, kortschakeling van de externe contacten te veroorzaken, het bloot te stellen aan temperaturen die buiten de normale gebruiksomgeving liggen of water of waterige vloeistoffen te geven.

#### Gevaar voor explosie als de batterij niet correct wordt geplaatst.

Het is niet toegestaan om de li-ionbatterij te demonteren, te doorboren, kortschakeling van de externe contacten te veroorzaken, het bloot te stellen aan temperaturen die buiten de normale gebruiksomgeving liggen of water of waterige vloeistoffen te geven.

#### Gevaar voor explosie als de batterij niet correct wordt geplaatst.

Het is niet toegestaan om de li-ionbatterij te demonteren, te doorboren, kortschakeling van de externe contacten te veroorzaken, het bloot te stellen aan temperaturen die buiten de normale gebruiksomgeving liggen of water of waterige vloeistoffen te geven.

#### Gevaar voor explosie als de batterij niet correct wordt geplaatst.

Het is niet toegestaan om de li-ionbatterij te demonteren, te doorboren, kortschakeling van de externe contacten te veroorzaken, het bloot te stellen aan temperaturen die buiten de normale gebruiksomgeving liggen of water of waterige vloeistoffen te geven.

#### Gevaar voor explosie als de batterij niet correct wordt geplaatst.

Het is niet toegestaan om de li-ionbatterij te demonteren, te doorboren, kortschakeling van de externe contacten te veroorzaken, het bloot te stellen aan temperaturen die buiten de normale gebruiksomgeving liggen of water of waterige vloeistoffen te geven.

#### Gevaar voor explosie als de batterij niet correct wordt geplaatst.

Het is niet toegestaan om de li-ionbatterij te demonteren, te doorboren, kortschakeling van de externe contacten te veroorzaken, het bloot te stellen aan temperaturen die buiten de normale gebruiksomgeving liggen of water of waterige vloeistoffen te geven.